4ch 送信器 IMT-40T マイコン内臓

送信距離　：各アンテナ最大1m、
　　サンプリング周期：8Hz
A/D分解能　：10bit
動作時間　：連続2ヶ月以上
寸　法　：W26×H13×L60mm / 重量：20g
入力ch数　：最大4ch
電源ON/OFF：外部マグネット
エポキシ樹脂モールド（内）
シリコンゴム（外）

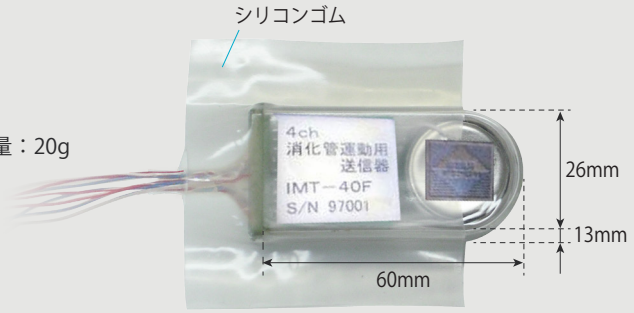

フォーストランスジューサー ×4

4ch 受信器 IMT-40RA

寸　法　：W260×D400×H80mm / 重量：2.5Kg
Hi-cut　：0.8、1.5、3Hz
GAIN　：×0.25、×1、×4、×1～×4連続可変
出　力　：1KΩアナログ電圧
アンテナ　：3本（塩ビの筒）
受信範囲　：約1m（いずれか受信良好な3本のアンテナ
　　信号を選別受信）

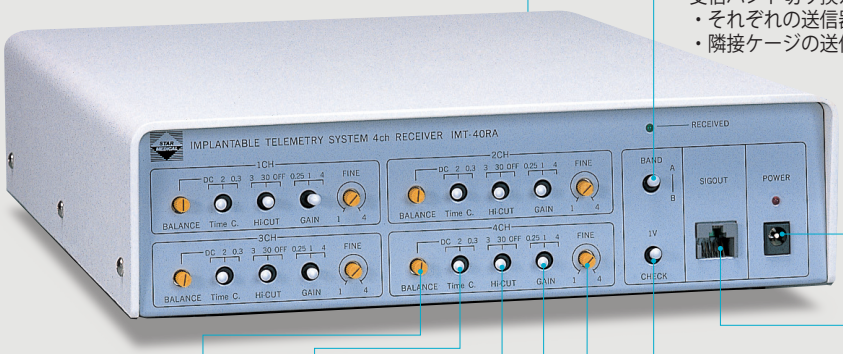

裏パネルに
電波・周波数のチューニングボリューム

受信バンド切り換えA/B
・それぞれの送信器に対応
・隣接ケージの送信器との混信防止

専用ＡＣアダプター

アナログ4ch信号

DCバランス
ボリューム

時定数
DC
2秒
0.3秒

High-Cut
3・30Hz
OFF

感度切り換え
×0.25
×1
×4

感度微調整
×1～×4
連続

チェック信号受信器
以降の機器、接続等の
チェック用の1V出力

4ch臓器運動テレメトリーシステム GTS-400

構　成

・4ch臓器運動用テレメーター 一式　IMT-400
　4ch送信器　IMT-40T
　4ch受信器　IMT-40RA
・パソコンシステム一式　ESC-8000
　収録ソフト　A/Dボード付き
　消化器Ⅱ解析ソフト　Analize Ⅱ
　パソコン、プリンター
・フォーストランスジューサー　F-08ISP×4

・収録ソフト
　チャンネル　1～8ch
　サンプリング　100μs～
　収録データのテキスト化
　テキストファイルの読み込み
　表示倍率　100cm/sec～
　　×1/20～×20倍（全チャンネル）
　　×1/10～×10倍（個別チャンネル）
　ch間　四則演算　微分
　　論理演算（<、=、>、≦、≧）

スターメディカル 株式会社
〒116-0013 東京都荒川区西日暮里5-14-12 太陽ビル 5F　Tel:(03)5604-1641　Fax:(03)5604-1645
E-mail:starmedical@starmedical.co.jp　http://www.starmedical.co.jp